OSTOFORM
FLOWASSIST Seal

Starten Sie mit Zuversicht. Starten Sie mit **FLOWASSIST**.

NEW & IMPROVED DESIGN


Noch anwendungsfreundlicher
Kein zusätzlicher Beutel-Zuschnitt erforderlich

Verbesserte Produkteigenschaften

Diskreter
Hautschutzring-Dicke auf 2 mm reduziert

So funktioniert's

FLOWASSIST, ein flexibler, nicht absorbierender Bestandteil des Hautschutzrings, der Haut und Klebstoff vor übermässiger Absorption und Erosion schützt. Der FLOWASSIST-Kanal leitet den Stuhlgang in den Stomabeutel, um **ein Auslaufen zu verhindern** und die **Haut besser zu schützen.**

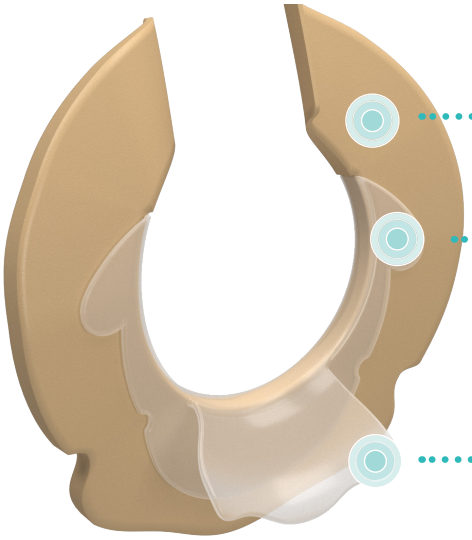

Geteiltes formbares Hydrokolloid
Für eine genaue Passform kann der gegen oben offene Hautschutzring modelliert werden.

FLOWASSIST
Der nicht absorbierende Bestandteil schützt die Haut und den Klebstoff vor übermässiger Absorption und Erosion.

FLOWASSIST-Kanal
Leitet den Stuhlgang von der Haut weg direkt in den Beutel.

FLOWASSIST VORTEILE

- Verbesserter Leckagenschutz
- Hydrokolloid-Schutz für längere Tragedauer
- Verbesserte Hautgesundheit
- Erstklassige Sicherheit und Komfort

FLOWASSIST, entwickelt, um Hautreizungen bei allen Stomatypen zu verhindern.

Bewährte Wirksamkeit in der peristomalen Pflege


Zu den klinischen Studien


Klinische Studien zu FLOWASSIST zeigen durchweg signifikante Verbesserungen der **peristomalen Hautgesundheit, eine längere Tragedauer**, und **positive Anwender-Erfahrungen.**

«Der FLOWASSIST war ein echter **Game-Changer**. Bei jedem Patienten, bei dem ich ihn eingesetzt habe, hat der FLOWASSIST eine entscheidende Veränderung bewirkt. Nun haben wir ihn im Spital vorrätig.»


Lisa, Wund-, Stoma,- und Inkontinenz Pflegefachfrau (WOC), USA

ANWENDUNGSLEITFADEN

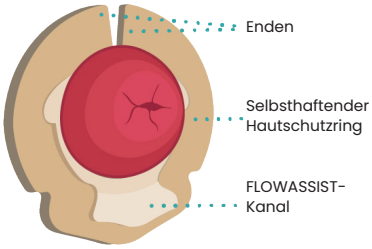


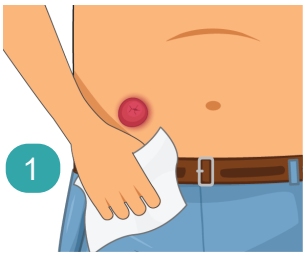


Waschen Sie Ihre Hände und stellen Sie sicher, dass die Haut um Ihr Stoma sauber und trocken ist. Erwärmen Sie den Hautschutzring für 30 Sekunden in Ihren Händen und entfernen Sie die Schutzfolie.

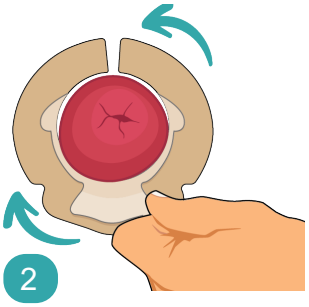


Positionieren Sie den FLOWASSIST-Kanal unterhalb des Stomas oder drehen Sie ihn so, dass er mit der Stoma-Öffnung übereinstimmt. Sie können den Kanal festhalten, um die Positionierung zu erleichtern.

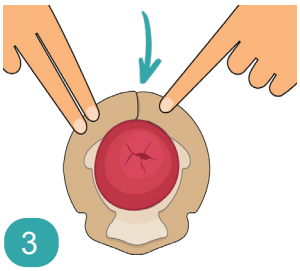


Legen Sie die Enden des Hautschutzrings um das Stoma. Achten Sie darauf, dass sich die Enden überlappen.

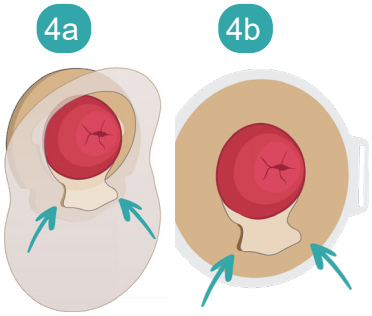

Bereiten Sie die Stomabeutelöffnung gemäss Herstellerangaben vor. Vergewissern Sie sich, dass sich der FLOWASSIST-Kanal vollständig in der Beutelöffnung befindet. Ziehen Sie dann den einteiligen Beutel (Abb. 4a) oder das zweiteilige Beutelsystem (Abb. 4b) so weit wie möglich unter den FLOWASSIST-Kanal.

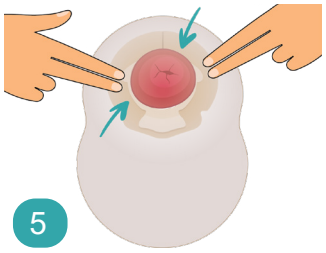

Üben Sie leichten Druck auf den Beutel aus, um eine sichere Verklebung zu erreichen.

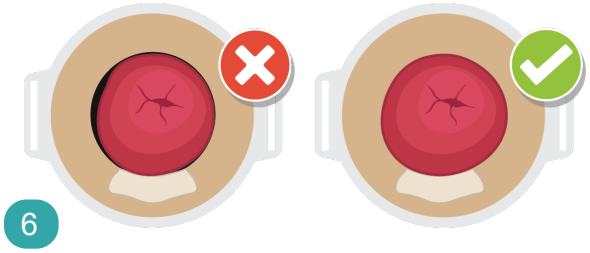

Prüfen Sie, dass nichts vom Hautschutzring sichtbar ist. Ansonsten positionieren Sie den Beutel so, dass er den Hautschutzring abdeckt.

Zum Anleitungs-Video

Bezeichnung	Artikel Nr.	Stoma-Grösse (mm)
Ostoform Flowassist Hautschutzring S	OFA-S-BX10	15 – 23 mm
Ostoform Flowassist Hautschutzring M	OFA-M-BX10	23 – 30 mm
Ostoform Flowassist Hautschutzring L	OFA-L-BX10	30 – 40 mm

Vertrieb Schweiz

MEDIQ

Mediq Suisse AG | Rosengartenstrasse 25 | 8608 Bubikon
Tel 052 720 25 26 | info@mediqsuisse.ch | www.mediqsuisse.ch

OSTOFORM
www.ostoform.com

OFLS16#2, Januar 2025